


Kontroll av infusions-, dialys- och spolvätskor

Gör så här innan du använder påsen/flaskan!

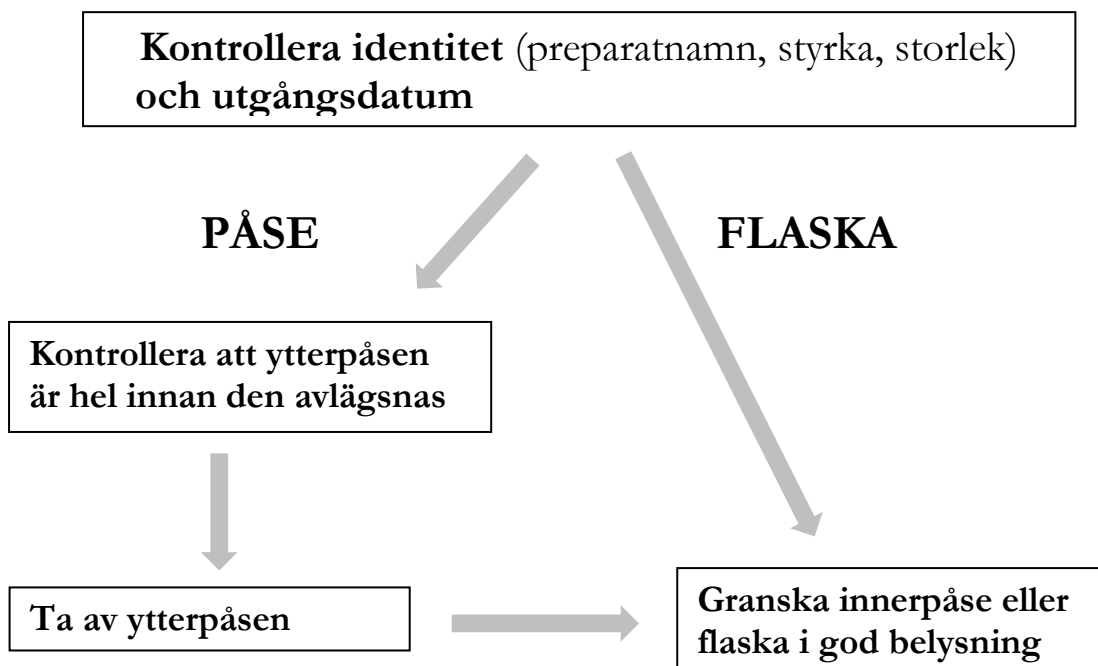

Observera!

Efter tillsats av läkemedel görs förnyad granskning av att ingen fällning eller annan grumling uppstått.

(Använd inte tuschpenna vid märkning på plast)

Returnera till läkemedelsenheten

- Läckande eller skadad påse/flaska eller sådan med avvikande volym
- Påse/flaska med fällning, missfärgad eller grumlig vätska
- Påse med defekta aggregat- och/eller tillsatsportar
- Flaska med skadad förslutning
- Flaska med skador i form av sprickor eller slagmärken

Lägg även in en reklamation i Synergi